
WiFi 智能温湿度记录仪 使用说明书

本使用说明书适用于 CQY2xx 系列产品



[关注微信 获取更多]

敬请仔细阅读本说明书

一、 产品介绍

成前 WiFi 温湿度记录仪是一款基于 IOT 技术的智能温湿度监控终端,可通过无线 WiFi 将数据传输至云平台。用户无需部署服务器,通过浏览器或手机 App 即可实现数据的实时监测、报警推送,历史查询、分析等功能。针对不同的温湿度环境需求,我们可提供**超低温、多路有线及无线自组网**等温湿度解决方案。本产品符合最新 GSP 标准,广泛应用于医药、食品、物流以及 HACCP 体系认证等行业。



注：产品外观以实物为准

二、显示说明



三、产品安装

本产品温湿度有线探头分为一体式与分体式两种

I 一体式记录仪使用方法

注：探头安装于设备上，简单方便

- 将设备固定于需要监控的地方
- 接通电源
- 配置设备（详见使用指南）



安装注意点：

- 设备初始温湿度显示为 30.0℃，60.0%，10S 后显示环境实时数据。
- 设备“嘀”声提示后，绿色指示灯会常亮，表示初始化完成，等待配置网络。

II 分体式记录仪使用方法

注：有线探头：标配 3 米，最大长度可定制为 25 米

无线探头：可实现有效传输距离为 180 米(空旷下)

- 将探头固定于需要监控的地方)
- 探头务必对准插牢，不要旋转
- 接通电源
- 配置设备（详见使用指南）



四、使用指南(1)

配置前准备

- 设备初始为热点模式，可通过手机搜索 WIFI 热点“CQTEK-AP”（**确认有没出现，不要连接**）
- 如手机搜索不到“CQTEK-AP”，请确认设备已开机并对设备进行复位。
- 复位步骤：断电重启，等待 5S，长按复位键 10S 操作后可再次搜索到“CQTEK-AP”热点。
- **手机接入可上网的 wifi 网络(能正常连接 internet)**（支持 2.4G WIFI，不支持 5G 网络）
- 下载“成前智联”app。



复位/配置按键

APP 下载

- 苹果手机在 App Store 搜索“成前智联”
- 安卓手机在华为市场 搜索“成前智联”，或者关注微信公众号“成前科技”，更多—app 下载。

账号登录

- 手机端：打开“成前智联”app，注册账号(**不支持大写字母**)，待审核通过。
- 电脑端：浏览器输入网址 <http://iot.chengqianyun.com/>，注册账号，待审核通过。
- 输入账号、密码登录。



iOS



Android

四、使用指南(2)

一键配置操作

- 点击界面右上角'+', 选择一键配置方式。



进入一键配置

所有设备		
RJ45 -test01	1#-E-A11	W2000301
27.78°C	27.42°C	26.48°C
65.14%	68.29%	69.16%
17-05-22 20:15	17-05-22 20:15	17-05-22 20:15
Tsetset	niepeng	W2000A01
27.20°C	27.56°C	27.10°C
68.13%	65.64%	74.29%
17-05-22 20:14	17-05-22 20:15	17-05-22 20:15
W2000B01	W2000D01	W2000G01
26.41°C	27.49°C	26.54°C
72.68%	65.07%	68.45%
17-05-22 20:15	17-05-22 20:15	17-05-22 20:15

- 输入wifi密码, 点击“配置”按钮。



添加设备

SSID: cqtek

密码:

配置

- 短按配置按键 1S, 即可在 30S 内完成配置操作。



注: SSID 显示手机连接的无线 wifi

四、使用指南(3)

- 配置完成即可显示本帐号此次添加的设备。



注：如果设备列表为空，参考常见问题

常见问题：

- 1, 设备绿灯常亮,没短按配置按键,需复位后重新配置操作。
- 2, 设备屏幕没有出现小圆点并且设备列表为空或者未跳转,网络原因服务器响应超时,需复位后重新配置设备

- 配置完成设备状态如下：

- 1, 屏幕左上角出现小圆点。



- 2, 5 分钟内屏幕时间更新为当前最新时间。


- 3, APP 自动添加设备并且设备为在线状态。

注：配置完成后如果设备屏幕左上角出现小圆点，APP 没自动添加设备，可以在添加方式里选择序列号添加，输入设备背面的 SN 号和 AC 码来完成添加设备操作。SN 为八位大写字符，AC 为八位小写字符。

五、基本参数

产品名称	WIFI 温湿度记录仪		产品型号	CQY210 (内置)	CQY211 (外置)
材料	ABS 阻燃材料		尺寸	120*100*35MM	
传感器	全数字温湿度传感器		符合标准	新版 GSP 标准	
温度量程	-20-65℃ (内置)	-40-85℃ (外置)	超低温	-100 - 65℃	
温度精度	±0.5℃		温度分辨率	0.1℃	
湿度量程	5% - 95%				
湿度精度	±3%		湿度分辨率	0.1%	
供电方式	5V DC		工作电流	<5MA	
记录方式	离线记录、在线补传		记录间隔	1 分钟	
报警方式	微信、短信、电话、APP 等		上网方式	无线 WIFI (2.4G)	
功能扩展	支持锂电池 (冗余供电)		支持停电来电		烟感/水浸/门磁
	外接声光报警器		无线温湿度探头		更多定制

六、结构尺寸

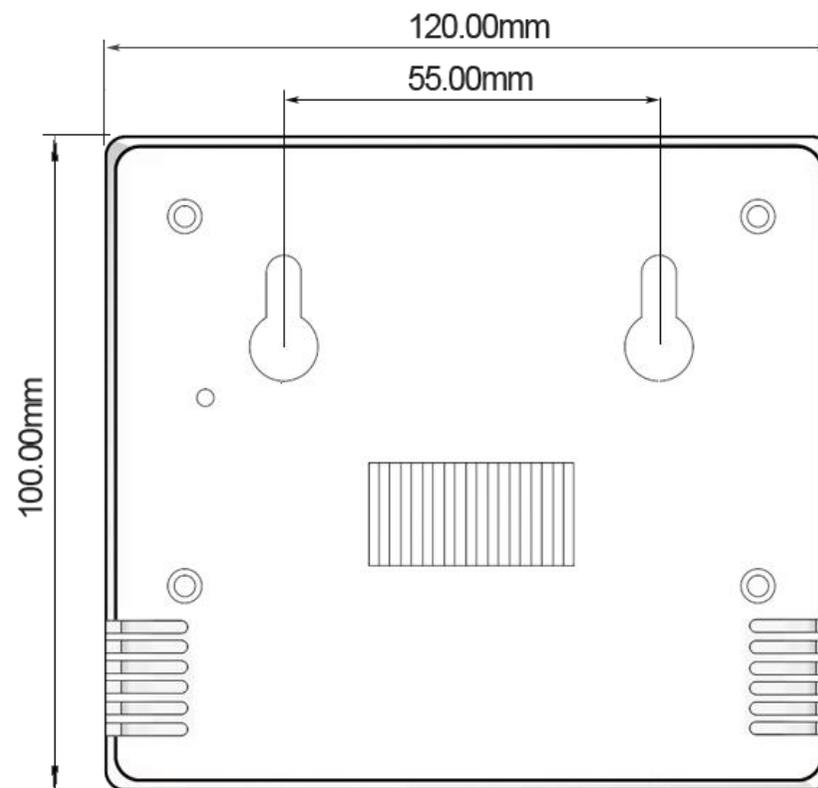

保修说明

保修条例

成前售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实现售后三包，服务内容如下：在三包有效期内，您可依照本规定免费享受维修、更换、退货的权利，退货应当凭购买凭据办理。

服务类型	服务政策
退货（产品质量）	自签收日期算起 7 天内产品质量原因退货
换货（产品质量）	自签收日期算起 15 天内产品质量原因换货
维修（产品质量）	自签收日期算起 1 年内产品质量原因维修

保修条例

属于下列情况(包括但不限于)不在“三包”服务范围之内：

- 1, 未经授权的维修、误用、碰撞、事故、改动、撕毁或涂改标签、序号。
- 2, 已超过三包有效期。
- 3, 因不可抗力造成的损坏。
- 4, 因人为原因造成设备功能性故障。

使用注意事项

在使用设备之前，请仔细阅读本章内容：

- 请在设备温湿度测量范围内使用本设备
- 请使用设备自带的电源适配器供电
- 请将设备或探头安装在离地 1.5 米位置，达到准确测量
- 如配置外置探头，请勿用力拉扯探头引线
- 如在 95%RH 以上湿度条件下测量，注意环境通风，防止探头部分结露，影响测量
- 请勿使用外力冲击本设备
- 请勿擅自拆卸本设备

合格证

产品名称： WIFI 温湿度记录仪

型号： CQY210 CQY211

CQY21X _____

检验员： _____

出厂日期： _____

专注实时数据监控

www.hz-cq.com

杭州成前科技有限公司

地址：杭州市科技大道 8-1 号正航创业园 4 幢

电话：0571-88192051